

Corset Siège

Société

Applicateur

Patient

Nom   
 Sexe  Age  Poids  Taille   
 Date des mesures   
 Délai souhaité

Mesures



Mesures finies  Mesures \_\_\_\_\_ + mm

Éléments fournis






Moulage  Photos  Fichier numérique

Mesures tête

Hauteurs Largeurs

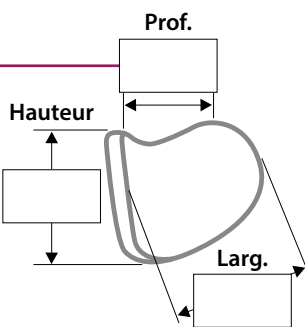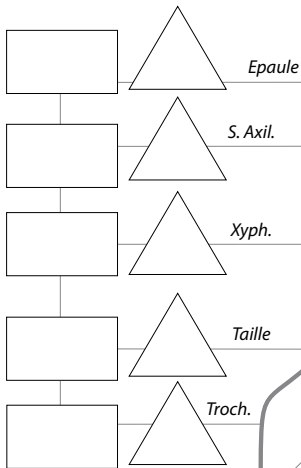

Mesures repose-pieds

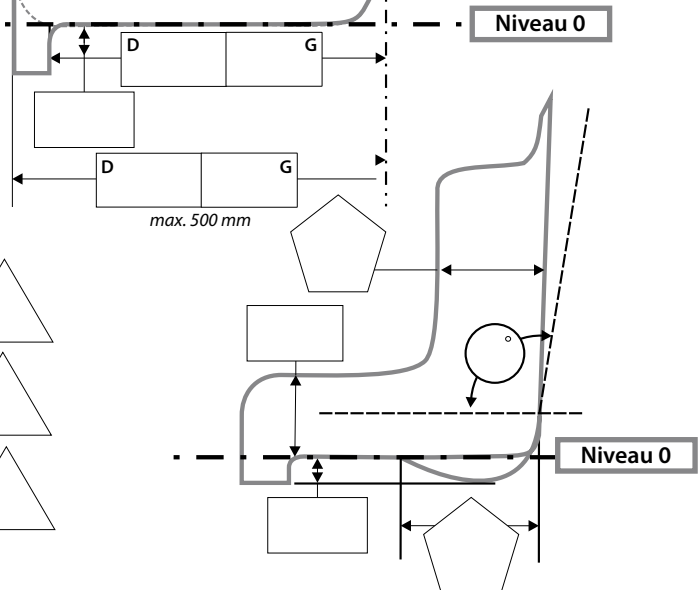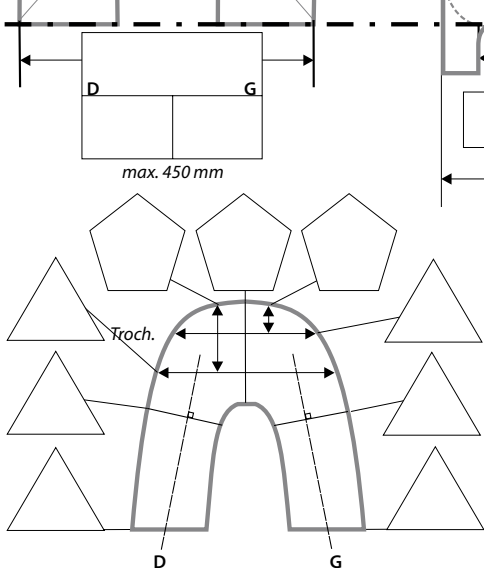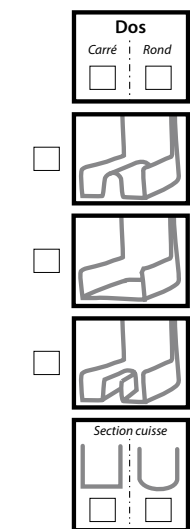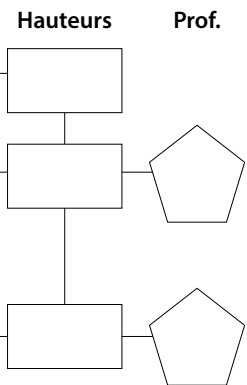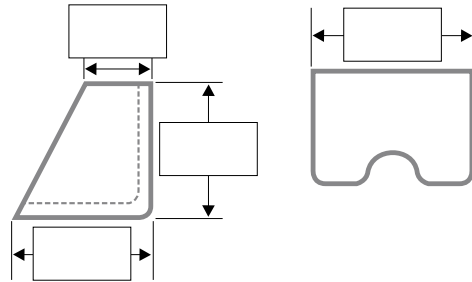

Cadre réservé à CSM

N° d'appareil   
 Opérateur

Réf. CSM production

Date 

 Demande de devis 

 Commande 

 Société 

 Adresse de livraison 

 Appicateur 

 Contre marque 

 Délai souhaité 
**Observations**

Références	Descriptif	Cde
SCS100	Scanner moulage	
SCR100	Rectification corset siège	
<b>FRAISAGE CORSET SIEGE</b>		
SCU100	Fraisage d'un corset siège hauteur max. 70 cm	
SCU200	Fraisage d'un corset siège retour de jambe	
<b>THERMOFORMAGE</b>		
SCT100	Thermoformage corset-siège polyéthylène + plastazote	
SCT110	Thermoformage plastazote supplémentaire	
<b>HOUSSE</b>		
SAT43HTF	Housse 3D thermoformée sur mesure	
SAT43HTF2	Housse 3D thermoformée sur mesure assise ou dossier	
<b>ADJONCTIONS</b>		
SAT43Z2	Tétière amovible ou non	
SAT43Z3	Tétière réglable au minimum dans les 2 plans	
SAT43Z3D	Tétière réglable au minimum dans les 3 plans	
SAT43Z18	Mentonnière	
SAT43Z4	Appui sous claviculaire rigide et réglable	
SAT43Z5	Appui sternal rigide et réglable	
SAT43Z7	Plot ABD amovible	
SAT43Z0809	Repose pieds segments pédieux et jambiers	
SAT43Z08SM	Repose pieds segments pédieux et jambiers sans montage	
SAT43Z08A	Montage articulation genou sur repose pieds	
SAT43Z10	Repose pieds monobloc	
SAT43Z10N	Repose pieds monobloc non monté	
SAT43Z11JB	Tablette standard Janton blanche	
SAT43Z11JT	Tablette standard Janton transparente	
SAT43Z12	Accoudoir	
SAT43Z16	Dispositif d'inclinaison socle ou dossier	
SAT43Z01	Socle de stabilisation	
SAT43Z06	Maintien antérieur thoracique et/ou abdomino-pelvien souple	
SAT43Z13	Dispositif de fixation du corset-siège à un support	
SAT43Z14	Dispositif de fixation du segment fémoral	
SAT43FOC	Adaptation lumières et renforts rigidité	
SAT43AF	Adaptation et finition	
SAT43ABDR	Plot ABD rapporté	
SAT43Z20	Coussin d'assise en gel	
SAT43Z21	Insert gel	

Matière	Épaisseur
Polyéthylène HP	

Mousse capiton	Couleur	Épaisseur
Plastazote		
Evazote		
Mémoire		
Tissu 3D		

Papier de transfert
Indiquer la référence souhaitée (reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris)
Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/>

Garniture
Plastron
Plastron à bretelles
Sangles bretelles
Sangles fémorales
Sangles abdominales
Sangles thoraciques
Poignée

Couleur châssis	
Bleu foncé	Fushia
Orange	Bleu clair
Vert	Rouge
Noir	


**Cadre réservé à CSM**

 N° d'appareil 

 Observations 

 Opérateur 

 Date de livraison