

**Société**

 Applicateur 
**Patient**

 Nom du patient 

 Sexe  Age  Poids  Taille 

 Côté droit  Côté gauche 

 Date des mesures 

 Délai souhaité 
**Éléments fournis**

- Fiche de mesures       Fichier numérique  
 Moulage avec fiche de mesures  
 Photos profil/face avec fiche de mesures

**Pathologie**
**Angulations genou**


- Valgum       Après correction  
 Varum       Après correction  
 Recurvatum       Après correction  
 Flexum       Après correction

**Angulations pied**


- Varus       Après correction  
 Valgus       Après correction  
 Flexion dorsale       Après correction  
 Flexion plantaire       Après correction

**OI carbone**

- OI monobloc  
 OI montant rivé sur coque carbone ou PE

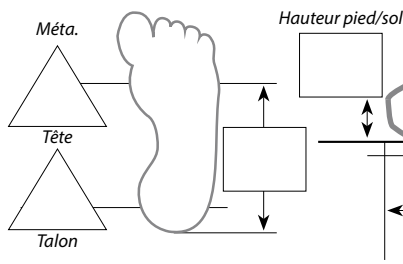

Indiquer plan de découpe

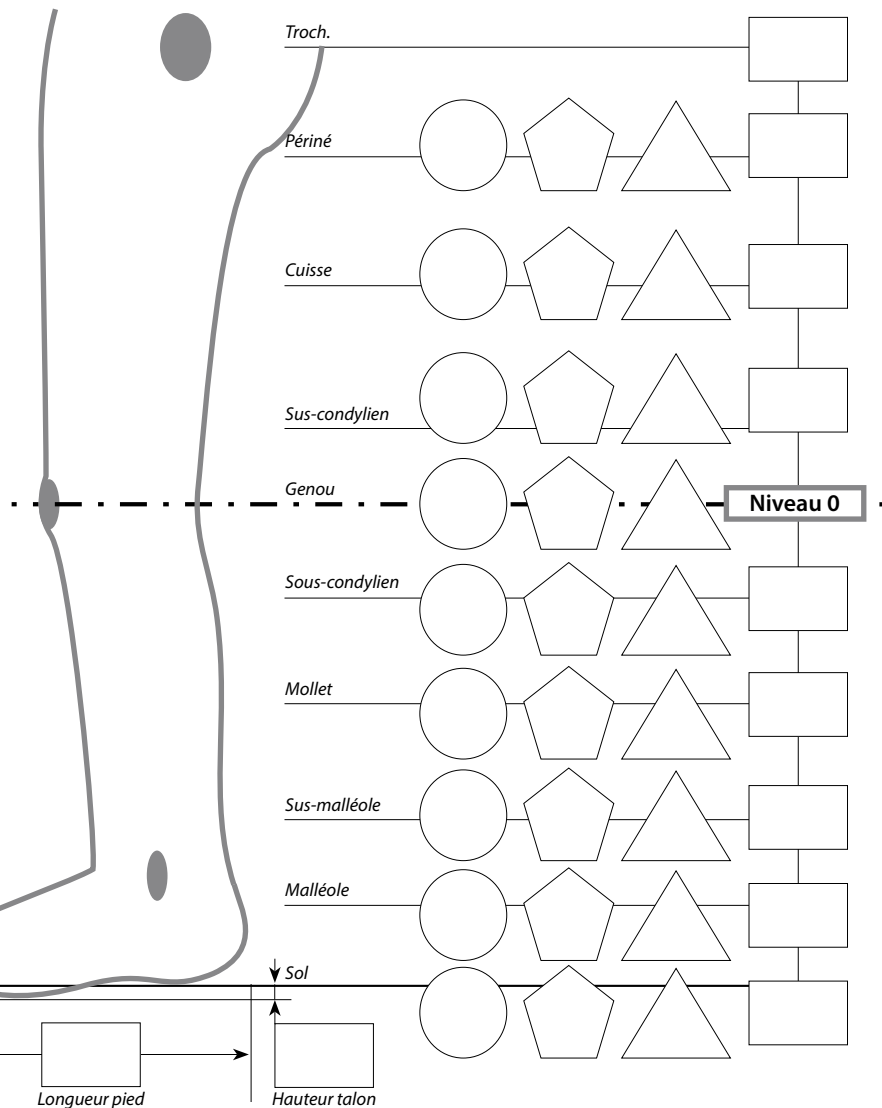
**Cadre réservé à CSM**

 N° d'appareil   
 Opérateur 

 Réf. CSM production

Date 

 Demande de devis 

 Commande 

 Société 

 Adresse de livraison 

 Appicateur 

 Contre marque 

 Délai souhaité 
**Observations**


---

Matière	Épaisseur
Polyéthylène HP	
Polypropylène	
Polypropylène copolymère	

Mousse capiton	Couleur	Épaisseur
Plastazote		
Tissu 3D		

Papier de transfert	
Indiquer la référence souhaitée <i>(reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris)</i>	
<input type="text"/>	
Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/>	

Articulation	
Genou	<input type="checkbox"/>
Cheville	<input type="checkbox"/>
Autre	<input type="checkbox"/>

Sangle velcro	Matière	Couleur
PVC		
PU		

Références	Descriptif	Cde
SFS100	Scanner un moulage	
SFR100	Rectification orthèse membre inférieur	
SOI36F	Fraisage genouillère maxi H. 70 cm	
SOI39F	Fraisage orthèse mi maxi H. 110 cm	
SOIMP	Préparation d'un contre moule plâtré	
<b>THERMOFORMAGE</b>		
SOI36T	Thermoformage OI 36	
SOI39T	Thermoformage OI 39	
<b>ORTHÈSE THERMOFORMÉ ACIER / DURAL</b>		
SOI39MJCP	Montage jambe et cuisse polypro OI36 / 39 (4 montants) (Articulations non comprises)	
SOI39MJPE	Montage jambe polypro, embrasses cuisse OI39, à l'essai (Articulations non comprises)	
SOIACS	Articulation de cheville souple sur une botte thermoformée	
<b>ORTHÈSE EMBRASE ACIER / DURAL</b>		
SOI39MADE	Montage orthèse acier ou dural à étrier	
SOI39MADT	Montage orthèse acier ou dural à tourillons	
SOI39ME	Montage étrier	
SOI39MST	Montage semelle tourillon	
<b>ADAPTATION ORTHÈSE</b>		
SOI39AFP	Adaptation et finition orthèse après essai	
SOI39RMD	Montage/démontage orthèse	
SOIBVH	Former et braser un verrou Hoffa	
<b>FINITION ORTHÈSE</b>		
SOI39GCP	Garniture orthèse tissu 3D + velcros + gainage montants	
SOI39GTGV	Garniture tissu 3D + velcros	
SOI39G200	Garniture classique cuir chausson étrier	
SOI39G210	Garniture classique cuir tourillons	
SOI39G220	Garniture classique cuir chausson	
SOI39G110	Garniture fronde genou	
SOI39G100	Rappel dynamique réglable système BOA	
SOIMCM	Cuir moule cuisse ou mollet ou chausson	

**Cadre réservé à CSM**


---

 N° d'appareil 

 Observations 

 Opérateur 

 Date de livraison