

Société

Applicateur

Patient

Nom du patient

Sexe Age Poids Taille

Côté droit Côté gauche

Date des mesures

Délai souhaité

Éléments fournis

- Fiche de mesures
- Fichier numérique
- Moulage avec fiche de mesures
- Photos profil/face avec fiche de mesures

Angulations

Après correction

- Valgum
- Varum
- Recurvatum
- Flexum

Pathologies
Laxité chronique

- Traumatique
- Neurologique
- Rhumathologique

Gonarthrose fémoro-tibiale

- Défaut d'axe
- Sans défaut d'axe

Défaut d'axe cruro-jambier

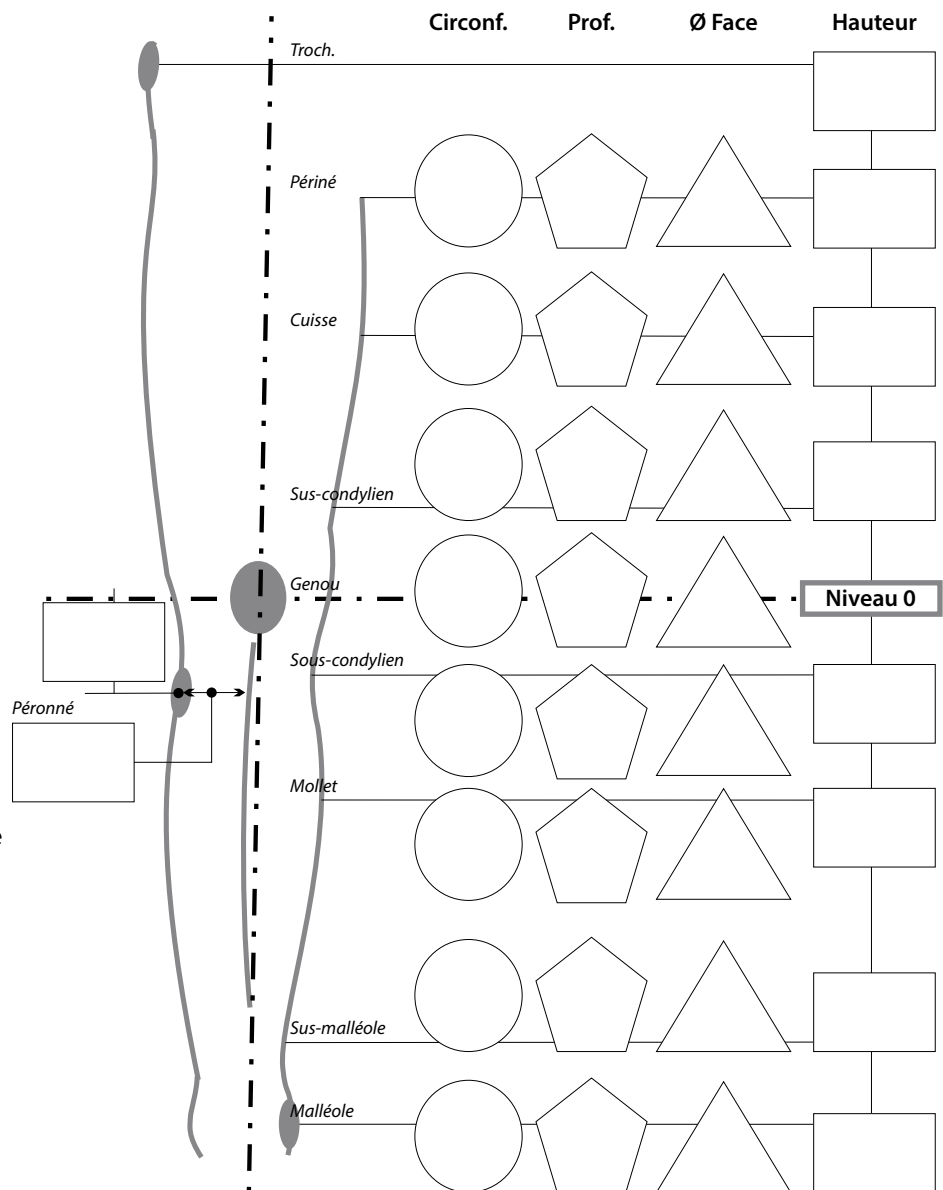
- Varum = appui sus malléolaire interne et sus condylien externe
- Valgum

Déformation articulaire

- Polyarthrite rhumatoïde
- Autre : _____

Lésion articulation fémoro-patellaire

- Chondrite
- Arthrose


Cadre réservé à CSM

N° d'appareil Réf. CSM production

Opérateur

Genouillère CKB

 Date

 Demande de devis

 Commande

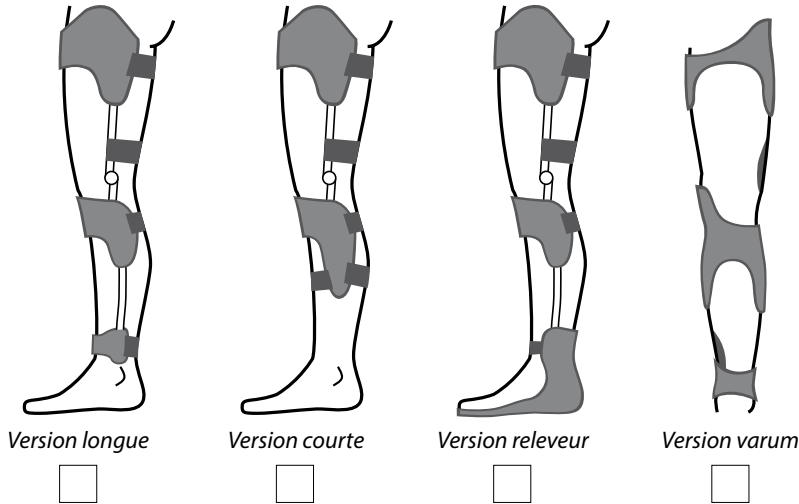
 Société

 Adresse de livraison

 Appicateur

 Contre marque

 Délai souhaité

 Observations

Éléments à fournir pour la modélisation

Moulage avec une fiche de mesures

OU

Fiche de mesures

OU

Photos profil/face avec une fiche de mesures

OU

Fichier numérique STL (Stereolytographique)

Élément à fournir pour le fraisage

Fichier numérique Rodin 4D

OU

Fichier numérique STL (Stereolytographique)

OU

Photo Captevia (CPV)

Références	Descriptif	Cde
SOI39CKBV	Orthèse carbone CKB (version varum)	
SOI39CKBL	Orthèse carbone CKB (version longue)	
SOI36CKBC	Orthèse carbone CKB (version courte)	
SOI39CKBRP	Orthèse carbone CKB (releveur polypropylène)	
SRIKVCANCKB	Kit renouvellement garniture : sangles velcros, cache articulation, Tissu 3D, 4 velcros, 1,5 m de velcro autocollant pour CKB	

Cadre réservé à CSM

 N° d'appareil

 Opérateur

 Date de livraison

 Observations