

Société

Applicateur

Patient

Nom du patient

Sexe Age Poids Taille

Côté droit Côté gauche

Date des mesures

Délai souhaité

Éléments fournis

Fiche de mesures Fichier numérique

Moulage avec fiche de mesures

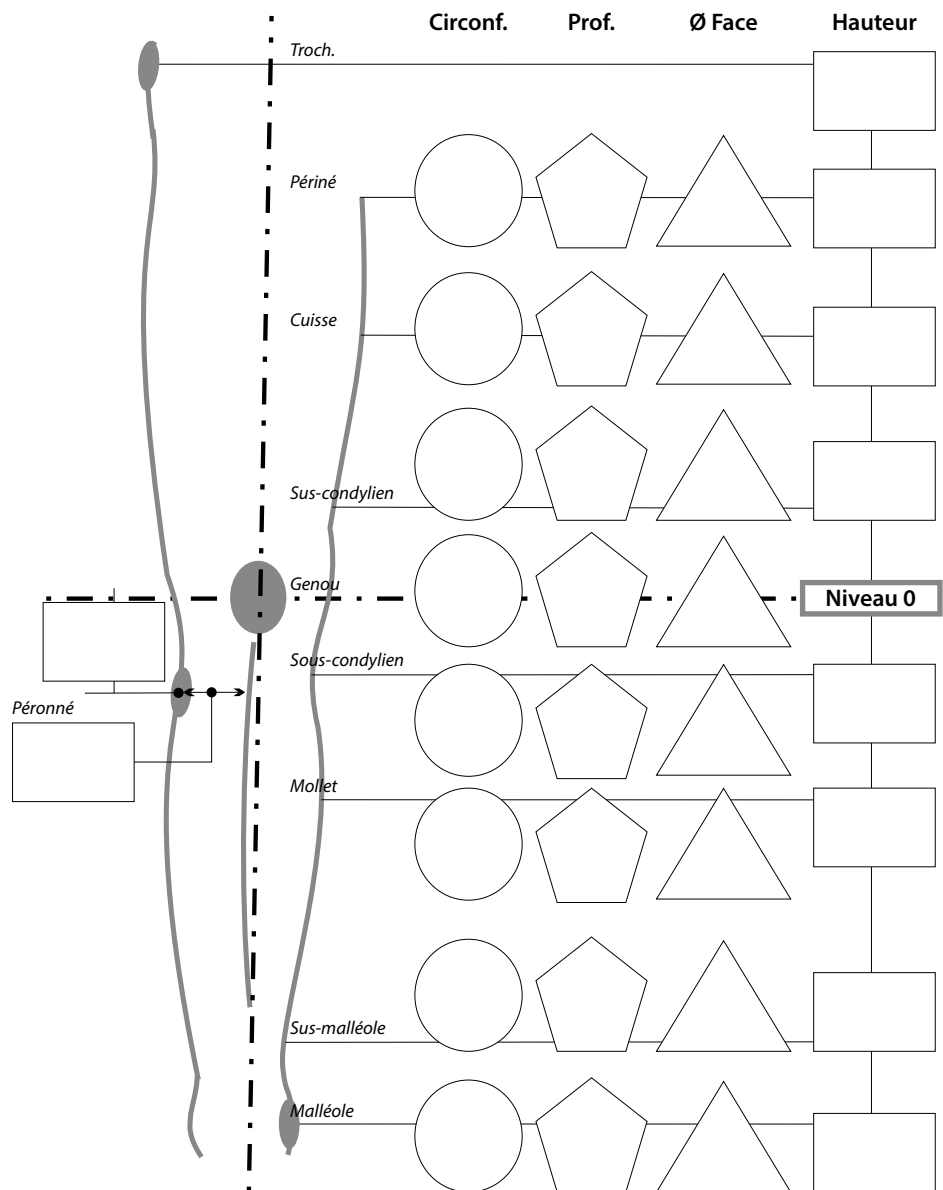
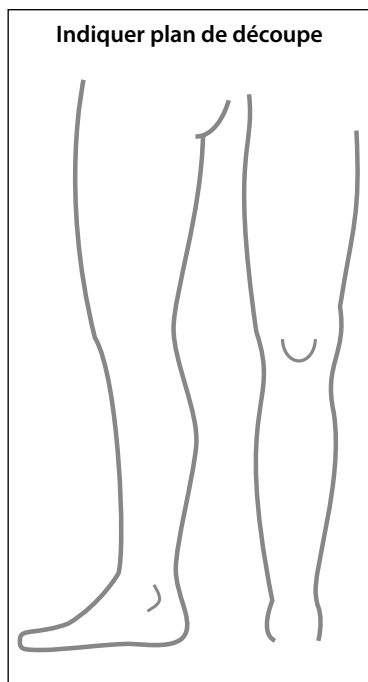
Photos profil/face avec fiche de mesures

Angulations

Valgum Varum

Recurvatum Flexum

Après correction


Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Opérateur

Réf. CSM production

Date

 Demande de devis

 Commande

 Société

 Adresse de livraison

 Applicateur

 Contre marque

 Délai souhaité
Éléments à fournir pour la modélisation

- Moulage avec une fiche de mesures
OU
 Fiche de mesures
OU
 Photos profil/face avec une fiche de mesures
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)

Élément à fournir pour le fraisage

- Fichier numérique Rodin 4D
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)
OU
 Photo Captevia (CPV)

Observations

| Références | Descriptif | Cde |
|---------------------------|---|-----|
| SGS100 | Scanner moulage | |
| SGR100 | Rectification genouillere | |
| SOI36F | Fraisage genouillère maxi H. 70 cm | |
| SOIMP | Préparation d'un contre moule plâtré | |
| THERMOFORMAGE | | |
| SOI36T | Thermoformage OI36 | |
| SOI36FT | Fraisage + thermoformage OI36 | |
| Polyoléfine | | |
| SOI36MJCP | Montage genouillère (4 montants sur articulation de genou) | |
| SOI36FTM | Rectification + fraisage + thermoformage + finition/articulation polycentrique inox gamme PU Janton | |
| SOI36MAD | Montage orthèse acier ou dural à embrasses OI36 | |
| ADAPTATION ORTHÈSE | | |
| SOI36AFP | Adaptation et finition genouillère après essai | |
| SOI39RMD | Montage démontage orthèse | |
| SOIBVH | Former et braser un verrou Hoffa | |
| FINITION ORTHÈSE | | |
| SOI39GCP | Garniture orthèse tissu 3D + velcros + gainage montants | |
| SOI39TGV | Garniture tissu 3D + velcros | |
| SOIMCM | Cuir moulé cuisse ou mollet + montage | |
| SOI36G200 | Garniture classique cuir | |
| SOI39G110 | Garniture fronde genou | |
| SOI39G100 | Rappel dynamique réglable système BOA | |
| Carbone | | |
| SOI36SKBAP | Genouillère carbone SKB articulation polycentrique plastique | |
| SOI36SKBPU | Genouillère carbone SKB articulation polycentrique inox | |

| Matière | Épaisseur |
|--------------------------|-----------|
| Polyéthylène HP | |
| Polypropylène | |
| Polypropylène copolymère | |

| Mousse capiton | Couleur | Épaisseur |
|----------------|---------|-----------|
| Plastazote | | |
| Tissu 3D | | |

| Articulation | |
|--------------|--|
| Genou | |
| Cheville | |
| Autre | |

| Sangle velcro | Matière | Couleur |
|---------------|---------|---------|
| PVC | | |
| PU | | |

Cadre réservé à CSM

 N° d'appareil

 Observations

 Opérateur

 Date de livraison