

Société

Applicateur

Patient

Nom du patient

Sexe Age Poids Taille

Côté droit Côté gauche

Date des mesures

Délai souhaité

Éléments fournis

Fiche de mesures Fichier numérique

Moulage avec fiche de mesures

Photos profil/face avec fiche de mesures

Informations

Releveur de pied Botte articulée

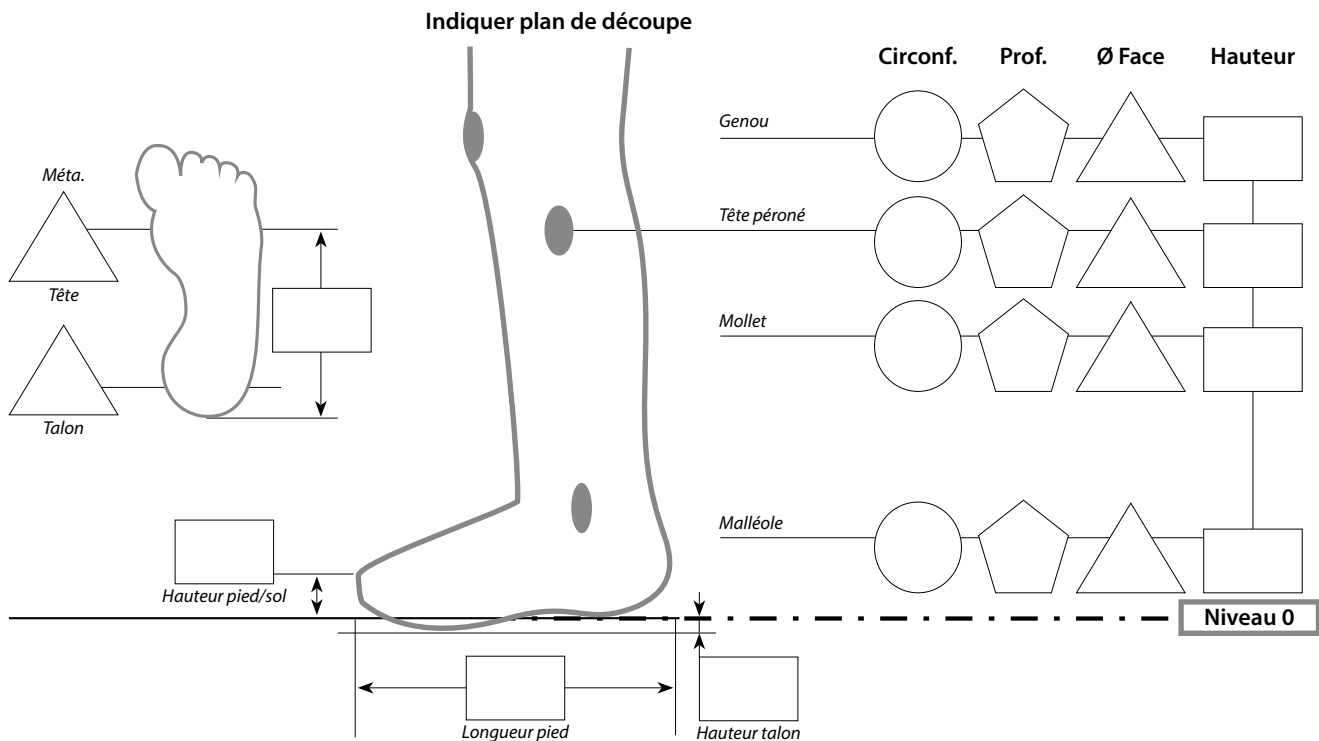
Botte rigide Nocturne Diurne

Angulations pied

Varus Valgus

Flexion dorsale Flexion plantaire

Après correction

Observations
Cadre réservé à CSM

N° d'appareil Réf. CSM production

Opérateur

Date

 Demande de devis

 Commande

Société _____

Adresse de livraison _____

 Applicateur

 Contre marque

 Délai souhaité

Observations _____

Éléments à fournir pour la modélisation

Moulage avec une fiche de mesures
OU
 Fiche de mesures
OU
 Photos profil/face avec une fiche de mesures
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)

Élément à fournir pour le fraisage

Fichier numérique Rodin 4D
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)
OU
 Photo Captevia (CPV)

Matière	Épaisseur
Polyéthylène HP	
Polypropylène	
Polypropylène copolymère	

Mousse capiton	Couleur	Épaisseur
Plastazote		
Tissu 3D		

Papier de transfert	
Indiquer la référence souhaitée <i>(reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris)</i>	
Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/>	

Articulation	
Cheville	
Autre	

Sangle velcro	Matière	Couleur
PVC		
PU		

Références	Descriptif	Cde
SBS100	Scanner moulage	
SBR100	Rectification botte	
SBU100	Fraisage botte maxi H. 64 cm	
SOIMP	Préparation d'un contre moule platré	

Composite		
SOI59CRL3	Releveur carbone lame JAD en 3 parties	
SOI59CRL	Releveur carbone lame JAD	
SOI59CAEL	Anti effondrement carbone lame JAD	
SOI59CAR	Botte carbone 1 articulation à rappel comprise	
SOI59LCC	Lame composite carbone sur mesure JAD	
SOI59C	Botte carbone	

Polyoléfine		
SOI59T	Botte releveur thermoformée	
SOIACS	Articulation de cheville souple sur une botte thermoformée	
SOI59ODAP1	Orthèse de Décharge Absolu du Pied	
SOI59ODAP2	Orthèse de Décharge Partielle du Pied	

FINITION ORTHÈSE		
SOI59G	Garniture tissu + velcro	

Cadre réservé à CSM

 N° d'appareil

 Observations

 Opérateur

 Date de livraison